



10

Левая боковая стенка условно не показана

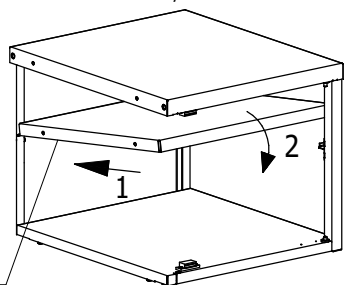

11


x 2 шт. x 2 шт.

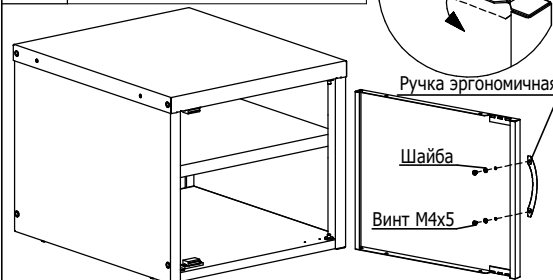

Одеть дверцу на оси. При необходимости (ось не входит в отверстие двери) очистить отверстие от излишков краски.

12

x 16 шт.

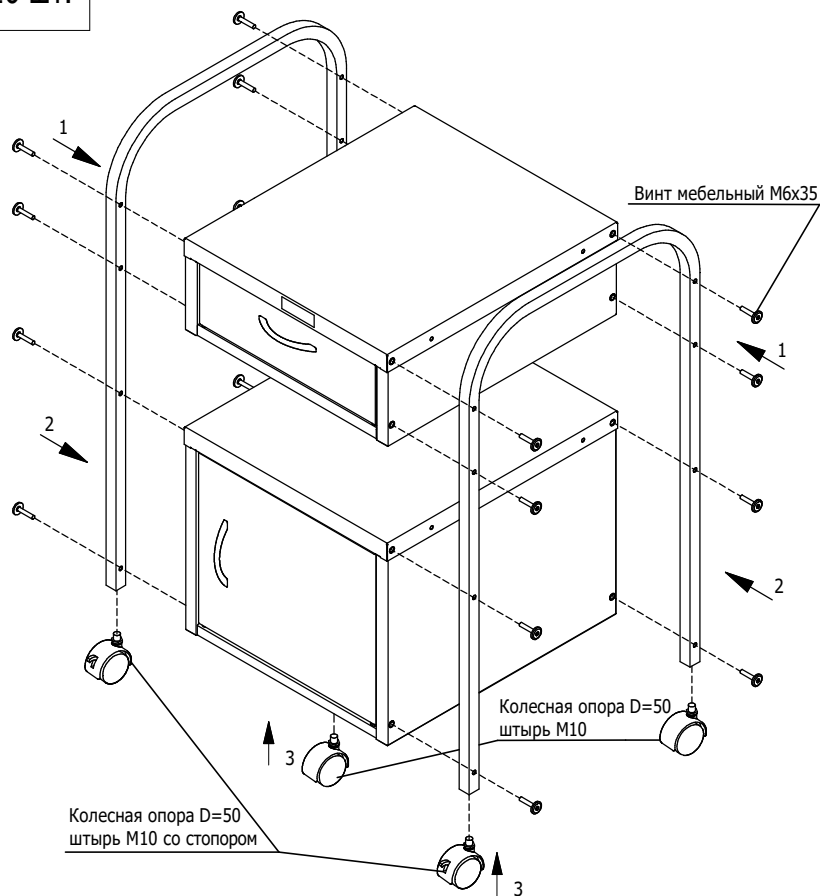

Пояснения к инструкции

- Последовательность сборки указана порядковым номером в верхнем левом углу каждого изображения сборочной операции
- Тип и количество крепежных изделий (если они требуются) для сборочной операции указано рядом с порядковым номером сборочной операции.

Тумба медицинская МД ТПЛ-5



Инструкция по сборке

